

CHROMagar™ **Vibrio**

Instructions For Use

Available in several languages

NT-EXT-017

Version **8.0**

ENGLISH

English Version

FRANCAIS

Version Française

ESPAÑOL


Version Español

DEUTSCH

Deutsch Version

日本

日本版

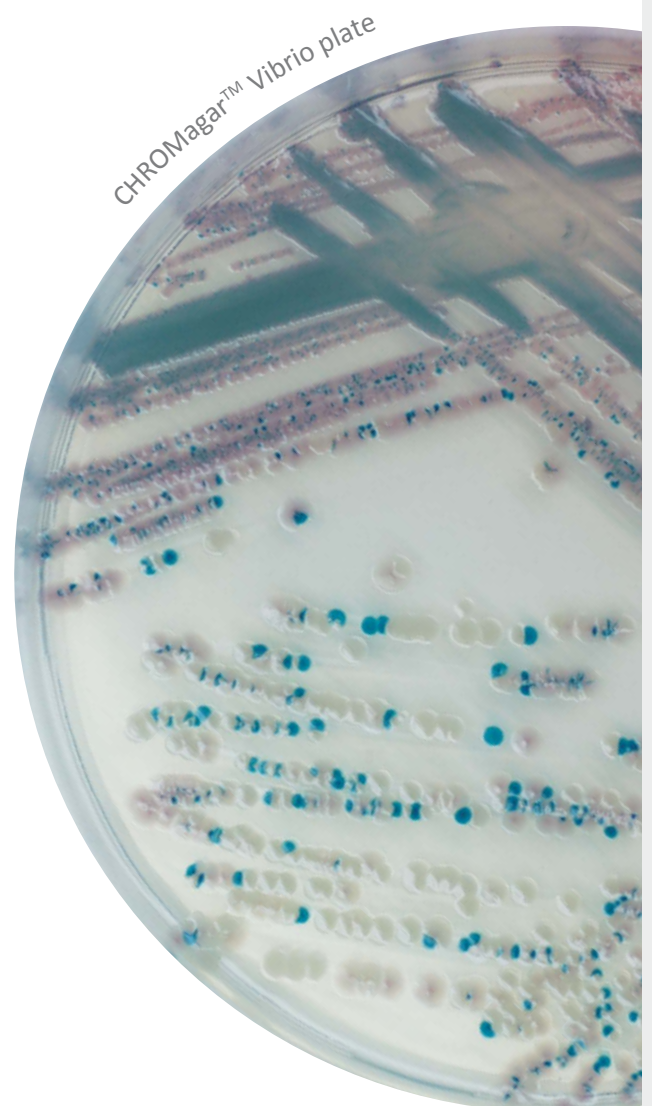

MEDIUM PURPOSE

Chromogenic medium for isolation and detection of *V. parahaemolyticus*, *V. vulnificus* and *V. cholerae*.

Naturally present on marine plants and animals, *Vibrio* genus counts over 20 species among which four (*V. parahaemolyticus*, *V. vulnificus*, *V. alginolyticus* and *V. cholerae*) represent a serious public health hazard.

COMPOSITION

The product is composed of a single powder base.

Product	=	Pack
Total g/L		74.7 g/L
Composition g/L		Agar 15.0 Peptone and yeast extract 8.0 Salts 51.4 Chromogenic mix 0.3
Aspect		Powder Form
STORAGE		15/30 °C
FINAL MEDIA pH		9.0 +/- 0.2

PREPARATION (Calculation for 1 L)

Step 1

Preparation of the mix

- Disperse slowly 74.7 g of powder base in 1 L of purified water.
 - Stir until agar is well thickened.
 - Heat and bring to boil (100 °C) while swirling or stirring regularly.
- DO NOT HEAT TO MORE THAN 100 °C. DO NOT AUTOCLAVE AT 121 °C.

Warning 1: If using an autoclave, do so without pressure.

Advice 1: For the 100 °C heating step, mixture may also be brought to a boil in a microwave oven: after initial boiling, remove from oven, stir gently, then return to oven for short repeated bursts of heating until complete fusion of the agar grains has taken place (large bubbles replacing foam).

Step 2

Pouring

- Cool in a water bath at 45-50 °C, swirling or stirring gently.
- Advice 2:** In case of samples with a high presence of *Aeromonas*, 50 mg of cefsulodin can be added to the mix once cooled down at 45-50 °C (50 mg/L).
- Pour medium into sterile Petri dishes.
 - Let it dry and gel.

Storage

- Store in the dark before use.
- Prepared media plates can be kept for one day at room temperature.
- Plates can be stored for up to 1 month under refrigeration (2/8 °C) if properly prepared and protected from light and dehydration.

INOCULATION

Related samples can be processed by direct streaking on the plate, as well as prior appropriate enrichment step.

- If the agar plate has been refrigerated, allow to warm to room temperature before inoculation.
- Streak sample onto plate.
- Incubate at 37 °C for 24 h in aerobic conditions.

Typical Samples


e.g. environmental, water,
seafood, surfaces

Direct streaking
or spreading technique

INTERPRETATION

Microorganism	Typical colony appearance
<i>V. parahaemolyticus</i>	→ mauve
<i>V. vulnificus</i> / <i>V. cholerae</i>	→ green blue to turquoise blue
<i>V. alginolyticus</i>	→ creamy

Typical colony appearance

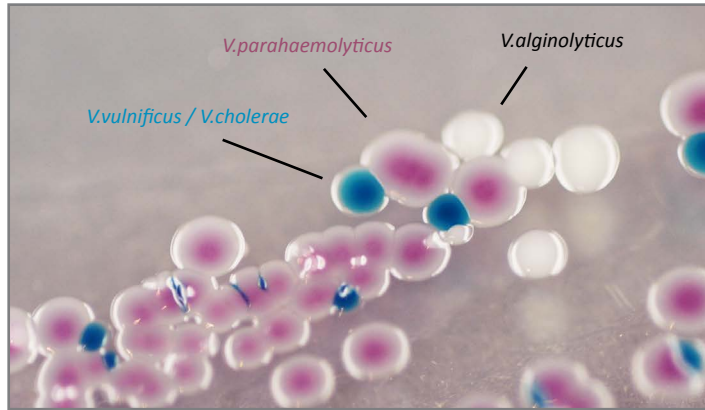

The pictures shown are not contractual.

PERFORMANCE & LIMITATIONS

- The final identification must be confirmed by biochemical tests or by mass spectrophotometry (eg. MALDI-TOF). They can be done directly from the suspicious colonies observed on the medium.
- For the Oxydase test of blue colonies, we suggest the use of normal Oxydase test.
- For the Oxydase test of mauve colonies, we suggest the use of a reagent giving a blue colour with oxydase positive bacteria (tetramethyl-p-phenylenediamine solution at 10 mg/mL).

QUALITY CONTROL

Please perform Quality Control according to the use of the medium and the local QC regulations and norms. Good preparation of the medium can be tested, isolating the ATCC strains below:

Microorganism	Typical colony appearance
<i>V. vulnificus</i> ATCC® 27562 *	→ green
<i>V. parahaemolyticus</i> ATCC® 33845	→ mauve
<i>V. alginolyticus</i> ATCC® 33839	→ creamy
<i>S. aureus</i> ATCC® 25923	→ inhibited
<i>E. coli</i> ATCC® 25922	→ inhibited

* It's highly recommended to use fresh strains for this isolate.

Σ Pack Size	Ordering References	Weight
5000 mL 250 Tests of 20 mL	VB912	Weight: 373.5 g
25L 1250 Tests of 20 mL	VB913-25	Weight: 1867.5 g

WARNINGS

- Do not use plates if they show any evidence of contamination or any sign of deterioration.
- Do not use the product beyond its expiry date or if product shows any evidence of contamination or any sign of deterioration.
- For Laboratory use. This laboratory product should be used only by trained personnel in compliance with good laboratory practices.
- Any change or modification in the procedure may affect the results.
- Any change or modification of the required storage temperature may affect the performance of the product.
- Inappropriate storage may affect the shelf life of the product.
- Recap the bottles/vials tightly after each preparation and keep them in a low humidity environment, protected from moisture and light.
- For a good microbial detection: collection and transport of specimen should be well handled and adapted to the particular specimen according to good laboratory practices.

DISPOSAL OF WASTE

After use, all plates and any other contaminated materials must be sterilized or disposed of by appropriate internal procedures and in accordance with local legislations. Plates can be destroyed by autoclaving at 121 °C for at least 20 minutes.

REFERENCES

Please refer to our website page «Publications» for scientific publications about this particular product.

Web link: <http://www.chromagar.com/publication.php>

IFU/LABEL INDEX

- Catalogue reference
- Consult instructions for use
- Quantity of powder sufficient for X liters of media
- Expiry date
- Required storage temperature
- Store away from humidity
- Protect from light
- Manufacturer

Need some Technical Documents?

Available for download on www.CHROMagar.com

- Certificate of Analysis (CoA) --> One per Lot
- Material Safety Data Sheet (MSDS)

CHROMagar™ and Rambach™ are trademarks created by Dr A. Rambach
ATCC® is a registered trademark of the American Type Culture Collection
NT-EXT-017 V8.0 / EN 05-May-21

OBJECTIF DU MILIEU

Milieu chromogène pour l'isolement et la détection des *V. parahaemolyticus*, *V. vulnificus* et *V. cholerae*.

Naturellement présents chez les plantes et les animaux marins, *Vibrio* compte plus de 20 espèces parmi lesquelles quatre (*V. parahaemolyticus*, *V. vulnificus*, *V. alginolyticus* et *V. cholerae*) représentent un grave danger pour la santé publique.

COMPOSITION

Ce produit est composé d'une base.

Produit	=	Pack
Total g/L		74,7 g/L
Composition g/L		Agar 15,0 Peptone et extraits de levure 8,0 Sels 51,4 Mix Chromogénique 0,3
Aspect		Poudre
STOCKAGE		15/30 °C
pH DU MILIEU FINAL		9,0 +/- 0,2

PRÉPARATION (Calcul pour préparer 1 L)

Étape 1

Préparation

- Disperser doucement 74,7 g de base dans 1 L d'eau purifiée.
 - Mélanger jusqu'à ce que l'agar soit bien gonflé.
 - Chauffer et porter à ébullition (100 °C) avec un mouvement de rotation lent et régulier.
- NE PAS CHAUFFER À PLUS DE 100°C. NE PAS AUTOCLAVER À 121 °C.

Attention n° 1 : Si vous utilisez un autoclave, l'utiliser sans pression.

Conseil n° 1 : Pour l'étape du chauffage à 100 °C, le mélange peut être porté à ébullition dans un four à micro-ondes : après une première ébullition, retirer du four et agiter doucement, puis remettre au four pour des courts chauffages répétés jusqu'à fusion complète des grains d'agar (grands bouillons remplaçant la mousse).

Étape 2

Coulage des boîtes

- Refroidir dans un bain marie à 45-50 °C, en mélangeant doucement.
- Conseil n° 2 :** Dans le cas d'échantillons contenant une forte charge d'*Aeromonas*, 50 mg de cefsulodine peut être ajouté au mélange une fois refroidi à 45-50 °C (50 mg /L).
- Couler dans des boîtes de Petri stériles.
 - Laisser solidifier et sécher.

STOCKAGE

- Conserver dans le noir avant usage.
- Les boîtes préparées peuvent être conservées un jour à température ambiante.
- Les boîtes peuvent être stockées jusqu'à 1 mois au réfrigérateur (2/8 °C) si elles ont été bien préparées et protégées de la lumière et de la déshydratation.

INOCULATION

Les échantillons appropriés peuvent être utilisés directement en isolement sur la boîte ou après une étape d'enrichissement.

- Si vos boîtes ont été réfrigérées, merci de les laisser revenir à température ambiante avant inoculation.
- Isoler l'échantillon sur la boîte.
- Incuber dans des conditions d'aérobies à 37 °C pendant 24 h.

Échantillons typiques

environnemental,
eau, fruits de mer, surfaces


Techniques
d'isolement
ou d'étalement

CHROMagar™ Vibrio

INTERPRÉTATION

Microorganisme	Apparence des colonies typiques
<i>V. parahaemolyticus</i>	→ mauve
<i>V. vulnificus</i> / <i>V. cholerae</i>	→ bleu vert à bleu turquoise
<i>V. alginolyticus</i>	→ crème

Apparence des colonies typiques

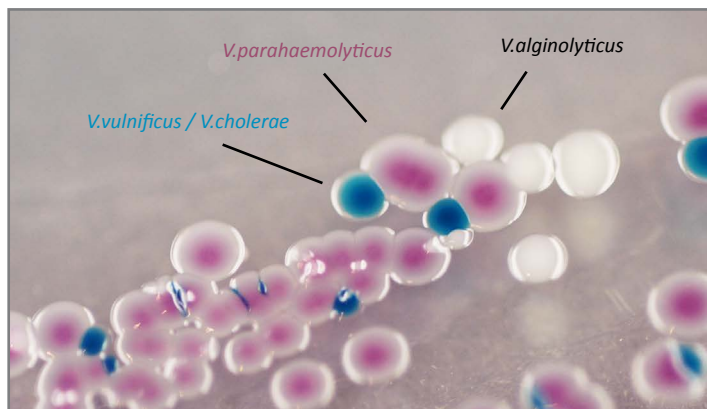

Photos non contractuelles

PERFORMANCE & LIMITATIONS

- L'identification finale doit être confirmée par des tests biochimiques ou par spectrophotométrie de masse (ex. : MALDI-TOF). Ils peuvent être faits directement depuis les colonies suspectes observées sur le milieu.
- Pour le test oxydase sur colonies bleues, nous suggérons l'utilisation du test oxydase normal.
- Pour le test oxydase sur colonies mauves, nous suggérons l'utilisation d'un réactif donnant une couleur bleue pour les bactéries oxydase(+) (solution tétraméthyl-p-phénylènediamine à 10 mg/mL).

CONTRÔLE QUALITÉ

Merci d'effectuer un contrôle qualité en accord avec l'utilisation du milieu et les normes locales de contrôle qualité. La bonne préparation du milieu peut être testée grâce à l'isolation de souches ATCC ci-dessous:

Microorganisme	Apparence des colonies typiques
<i>V. vulnificus</i> ATCC® 27562 *	→ vert
<i>V. parahaemolyticus</i> ATCC® 33845	→ mauve
<i>V. alginolyticus</i> ATCC® 33839	→ crème
<i>S. aureus</i> ATCC® 25923	→ inhibé
<i>E. coli</i> ATCC® 25922	→ inhibé

* Il est fortement recommandé d'utiliser des souches fraîches pour cet isolat.

Format du pack	Références de commande	Poids
5000 mL 250 Tests de 20 mL	VB912	373,5 g
25 L 1250 Tests de 20 mL	VB913-25	1867,5 g

CHROMagar™ et Rambach™ sont des marques créées par le Dr. A. Rambach
ATCC® est une marque enregistrée par l' American Type Culture Collection
NT-EXT-017 V8.0 / FR 05-May-21

ATTENTION

- Ne pas utiliser les boîtes si elles montrent un signe évident de contamination ou de détérioration.
- Ne pas utiliser notre produit au delà de sa date d'expiration ou si le produit montre des signes de contamination ou de détérioration.
- Produit de laboratoire. Ceci est un produit de laboratoire qui doit être utilisé par du personnel spécialisé et formé aux bonnes pratiques de laboratoire.
- Tout changement ou modification dans la procédure peut affecter les résultats.
- Tout changement ou modification de la température de stockage requise peut affecter la performance du produit.
- Une conservation inappropriée peut affecter la durée de vie du produit.
- Bien refermer les bouteilles/flacons après chaque préparation et les conserver dans un endroit à faible humidité, protégés de la lumière et de l'humidité.
- Pour une bonne détection microbienne, la collecte et le transport des échantillons doivent être bien gérés et adaptés à l'échantillon en accord avec les bonnes pratiques de laboratoire.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Après utilisation, toutes les boîtes et matériels contaminés doivent être stérilisés ou jetés selon des procédures internes et en accord avec la législation locale. Les boîtes peuvent être détruites par autoclavage à 121 °C pendant 20 minutes.

RÉFÉRENCES

Merci de vous référer à notre page «Publications» de notre site internet pour les publications scientifiques sur ce produit
Lien Internet: <http://www.chromagar.com/publication.php>

LEXIQUE ÉTIQUETTE

- REF** Référence catalogue
- Consulter les instructions d'utilisation
- Quantité de poudre suffisante pour X litres de milieu
- Date d'expiration
- Température de stockage requise
- Conserver à l'abri de l'humidité
- Protéger de la lumière
- Fabricant

Besoin de Documentation Technique?

Disponible en téléchargement sur www.CHROMagar.com

- Certificat d'analyse (CoA) --> Un par Lot
- Fiche de Sécurité (MSDS)

FINALIDAD DEL MEDIO

Medio cromogénico para el aislamiento y la detección de *V. parahaemolyticus*, *V. vulnificus* y *V. cholerae*.

Presente de forma natural en plantas y animales marinos, el género *Vibrio* cuenta con más de 20 especies de las que cuatro (*V. parahaemolyticus*, *V. vulnificus*, *V. alginolyticus* y *V. cholerae*) representan un riesgo grave para la salud pública.

COMPOSICIÓN

El producto se compone de una única base en polvo.

Producto	=	Pack
Total g/l		74,7 g/L
Composición g/l		Agar 15,0 Extracto de peptonas y levadura 8,0 Sales 51,4 Mezcla cromogénica 0,3
Aspecto		Forma en polvo
ALMACENAMIENTO		15/30 °C
pH FINAL DEL MEDIO		9,0 +/- 0,2

PREPARACIÓN (Cálculo para 1 L)

Paso 1

Preparación de la mezcla

- Suspender lentamente 74,7 g de base de polvo en 1 L de agua purificada.
 - Remover hasta que el agar haya espesado bien.
 - Calentar hasta la ebullición (100 °C) agitando o removiendo regularmente.
- NO CALENTAR A MÁS DE 100 °C. NO AUTOCLAVAR A 121 °C.**

Advertencia 1: Si utiliza un autoclave, hágalo sin presión.

Consejo 1: En el paso de calentamiento a 100 °C, la mezcla también puede llevarse a ebullición en un horno microondas: tras la ebullición inicial, retirar del horno, remover suavemente, y devolver al horno para aplicar breves y reiteradas sesiones de calentamiento brusco hasta lograr la fusión completa de los granos de agar (grandes burbujas sustituirán a la espuma).

Paso 2

Vertido

- Enfriar en una cubeta térmica a 45-50 °C, agitando o removiendo suavemente.
- Consejo 2:** En caso de muestras con alta presencia de *Aeromonas*, pueden añadirse 50 mg de cefsulodina a la mezcla una vez enfriado a 45-50 °C (50 mg/L).
- Verter el medio en placas de Petri estériles.
 - Dejar secar y gelificar.

Almacenamiento

- Almacenar en la oscuridad antes de usar.
- Las placas preparadas con medio pueden conservarse durante un día a temperatura ambiente.
- Las placas pueden almacenarse hasta 1 mes refrigeradas (2/8 °C) si se han preparado correctamente y se protegen de la luz y la deshidratación.

INOCULACIÓN

Las muestras relacionadas pueden procesarse mediante siembra directa por estrías en placa, así como realizando un paso previo de enriquecimiento.

- Si la placa de agar ha sido refrigerada, dejar que caliente a temperatura ambiente antes de la inoculación.
- Sembrar la muestra por estrías en la placa.
- Incubar a 37 °C durante 24 h en condiciones aerobias.

Muestras típicas


p. ej., medioambientales, agua, mariscos, superficies

Siembra directa en estrías
o en extensión

INTERPRETACIÓN

Microorganismo	Aspecto típico de las colonias
<i>V. parahaemolyticus</i>	→ malva
<i>V. vulnificus</i> / <i>V. cholerae</i>	→ de azul verdoso a azul turquesa
<i>V. alginolyticus</i>	→ crema

Aspecto **típico** de las colonias

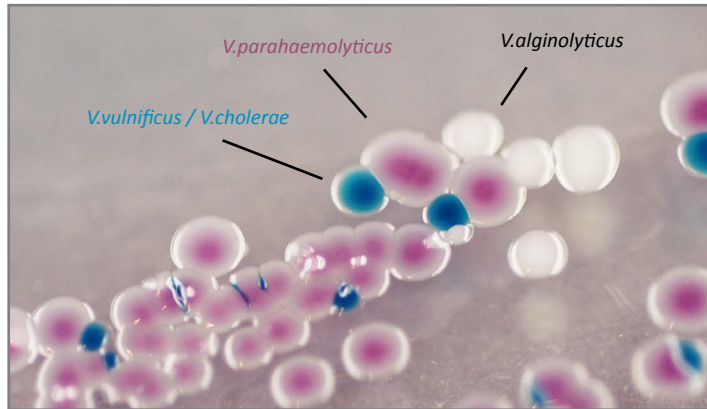

Las imágenes mostradas no son contractuales.

RENDIMIENTO Y LIMITACIONES

- La identificación final debe confirmarse mediante pruebas bioquímicas o por espectrofotometría de masas (por ejemplo, MALDI-TOF). Se pueden hacer directamente desde las colonias sospechosas observadas en el medio.
- Para la prueba de la oxidasa en caso de colonias azules, recomendamos el uso de la prueba de oxidasa normal.
- Para la prueba de la oxidasa en caso de colonias de color malva, recomendamos el uso de un reactivo que dé **color azul** con bacterias oxidasa positivas (solución de tetrametil-p-fenilendiamina a 10 mg/mL).

CONTROL DE CALIDAD

Realizar el control de calidad de acuerdo con la utilización del medio y los reglamentos y normas locales para QC. La correcta preparación del medio puede analizarse aislando las cepas ATCC que se enumeran más abajo:

Microorganismo	Aspecto típico de las colonias
<i>V. vulnificus</i> ATCC® 27562*	→ verde
<i>V. parahaemolyticus</i> ATCC® 33845	→ malva
<i>V. alginolyticus</i> ATCC® 33839	→ crema
<i>S. aureus</i> ATCC® 25923	→ inhibidas
<i>E. coli</i> ATCC® 25922	→ inhibidas

* Se recomienda encarecidamente utilizar cepas frescas para este aislado.

Tamaño del envase

5000 mL

250 pruebas de 20 mL

=

Referencias para pedidos

VB912

Peso: 373,5 g

25 L

1250 pruebas de 20 mL

=

VB913-25

Peso: 1867,5 g

PRECAUCIONES

- No utilice placas que muestren cualquier evidencia de contaminación o cualquier otro signo de deterioro.
- No utilizar el producto más allá de su fecha de caducidad o si el producto muestra cualquier evidencia de contaminación o cualquier otro signo de deterioro.
- Para uso en laboratorio. Este producto de laboratorio debe ser utilizado exclusivamente por personal cualificado conforme a las buenas prácticas de laboratorio.
- Cualquier cambio o modificación en el procedimiento puede afectar a los resultados.
- Cualquier cambio o modificación de la temperatura de almacenamiento requerida puede afectar al rendimiento del producto.
- Un almacenamiento inadecuado puede afectar la vida útil del producto.
- Volver a tapar herméticamente los frascos / viales después de cada preparación y mantenerlos en un ambiente de baja humedad, protegido de la condensación y la luz.
- Para una buena detección microbiana: la recogida y transporte de las muestras deberán realizarse y adaptarse a cada muestra concreta de acuerdo con las buenas prácticas de laboratorio.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Después de su uso, todas las placas y el resto de material contaminado deben esterilizarse o eliminarse mediante procedimientos internos apropiados y de acuerdo con las normativas locales. Las placas pueden destruirse mediante autoclavado a 121 °C durante al menos 20 minutos.

REFERENCIAS

Consulte nuestra página web "Publicaciones" para acceder a las publicaciones científicas sobre este producto en particular. [Enlace web: http://www.chromagar.com/publication.php](http://www.chromagar.com/publication.php)

ÍNDICE DE LAS INSTRUCCIONES / ETIQUETA

- Referencia de catálogo
- Consultar las instrucciones de utilización
- Cantidad de polvo suficiente para X litros de medio
- Fecha de caducidad
- Temperatura de almacenamiento requerida
- Almacenar protegido de la humedad
- Proteger de la luz
- Fabricante

¿Necesita algún documento técnico?

Disponible para su descarga en www.CHROMagar.com

- Certificado de análisis (CoA) --> Uno por lote
- Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)

CHROMagar™ y Rambach™ son marcas comerciales creadas por el Dr. A. Rambach. ATCC® es una marca registrada de la American Type Culture Collection. NT-EXT-017 V8.0 / ES 05-May-21

VERWENDUNGSZWECK

Chromogenes Medium zur Isolierung und zum Nachweis von *V. parahaemolyticus*, *V. vulnificus* und *V. cholerae*.

Zur Gattung *Vibrio*, die natürlicherweise auf Meerespflanzen und -tieren vorkommt, gehören über 20 Arten, von denen vier (*V. parahaemolyticus*, *V. vulnificus*, *V. alginolyticus* und *V. cholerae*) eine große Gefährdung für die öffentliche Gesundheit.

ZUSAMMENSETZUNG

Das Produkt besteht aus einer einzigen Base.

Produkt	=	Packung
Gesamt g/l		74,7 g/L
Zusammensetzung g/l		Agar 15,0 Pepton und Hefe-Extrakt 8,0 Salze 51,4 Chromogenmischung 0,3
Aussehen		Pulver
AUFBEWAHRUNG		15-30 °C
pH DES ENDMEDIUMS		9,0 +/- 0,2

ZUBEREITUNG (Berechnung für einen Liter)

Schritt 1

Zubereitung der Mischung

- 74,7 g der Base langsam in 1 L destilliertem Wasser resuspendieren.
- Rühren, bis der Agar aufgequollen ist.
- Unter regelmäßigem Rühren erhitzen und zum Kochen (100 °C) bringen. NICHT AUF ÜBER 100 °C ERHITZEN. NICHT BEI 121 °C AUTOKLAVIEREN.

Warnung 1: Bei Verwendung eines Autoklaven keinen Druck verwenden.

Hinweis 1: Die Suspension kann auch in der Mikrowelle auf 100 °C erhitzt werden: Nach kurzem Aufkochen aus der Mikrowelle nehmen und vorsichtig rühren. Anschließend mit mehreren kurzen Hitzestößen erneut in der Mikrowelle erhitzen, bis sich der Agar vollständig aufgelöst hat (große Blasen ersetzen den Schaum).

Schritt 2

Ausgießen

- Im Wasserbad auf 45-50 °C abkühlen, dabei vorsichtig schwenken oder rühren.
- **Hinweis 2:** Falls die Proben eine große Menge an *Aeromonas* enthalten, können 50 mg Cefsulodin zu der auf 45-50 °C abgekühlten Mischung gegeben werden (50 mg/L).
- Medium in sterile Petrischalen gießen.
- Trocknen und gelieren lassen.

Aufbewahrung

- Vor dem Gebrauch dunkel lagern.
- Fertige Platten können einen Tag bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.
- Die Platten können bis zu 1 Monat im Kühlschrank (2-8 °C) aufbewahrt werden, wenn sie sachgerecht zubereitet wurden und vor Licht und Austrocknung geschützt sind.

BEIMPEN

Die Proben können entweder direkt ausplattiert oder zunächst mit einer geeigneten Methode angereichert werden.

- Kühl gelagerte Agarplatten vor dem Beimpfen auf Raumtemperatur bringen.
- Probe auf der Platte ausstreichen.
- 24 Stunden bei 37 °C aerob inkubieren.

Typische Proben

z. B. Umgebungs- oder Wasserproben, Meeresfrüchte, Oberflächen


Direktes Ausstreichen oder Ausplattieren

CHROMagar™ Vibrio

INTERPRETATION

Mikroorganismus	Typisches Erscheinungsbild der Kolonien
<i>V. parahaemolyticus</i>	→ mauvefarben
<i>V. vulnificus</i> / <i>V. cholerae</i>	→ grünblau bis türkisblau
<i>V. alginolyticus</i>	→ cremefarben

Typisches Erscheinungsbild der Kolonien

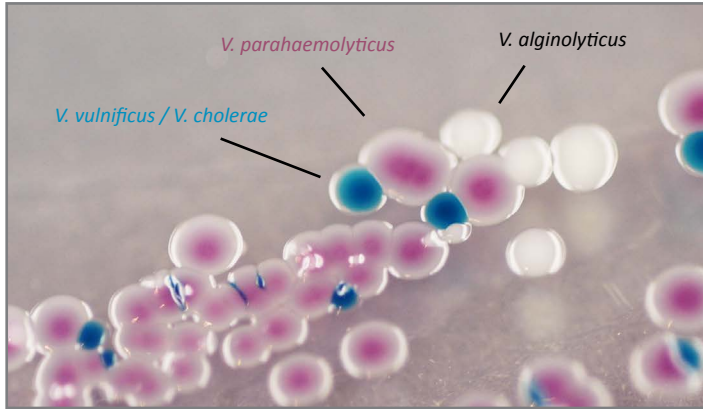

Die gezeigten Fotos sind unverbindlich.

LEISTUNGSMERKMALE UND VERFAHRENSBESCHRÄNKUNGEN

- Die endgültige Identifizierung muss durch biochemische Tests oder durch Massenspektrophotometrie (z. B. MALDI-TOF) bestätigt werden. Sie können direkt aus den auf dem Medium beobachteten verdächtigen Kolonien durchgeführt werden.
- Für den Oxydasetest an blauen Kolonien empfehlen wir die Anwendung des normalen Oxydasetests.
- Für den Oxydasetest an mauvefarbenen Kolonien empfehlen wir die Anwendung eines Reagenz, das sich bei Oxydase-positiven Bakterien **blau färbt** (Tetramethyl-p-Phenylendiamin-Lösung in einer Konzentration von 10 mg/mL).

QUALITÄTSKONTROLLE

Bitte führen Sie die Qualitätskontrolle je nach Gebrauch des Mediums und gemäß örtlichen Qualitätskontrollvorschriften und -normen durch.

Ob das Medium richtig hergestellt wurde, kann durch Isolierung der folgenden ATCC-Stämme getestet werden:

Mikroorganismus	Typisches Erscheinungsbild der Kolonien
<i>V. vulnificus</i> ATCC® 27562*	→ grün
<i>V. parahaemolyticus</i> ATCC® 33845	→ mauvefarben
<i>V. alginolyticus</i> ATCC® 33839	→ cremefarben
<i>S. aureus</i> ATCC® 25923	→ inhibiert
<i>E. coli</i> ATCC® 25922	→ inhibiert

* Es wird dringend empfohlen, für dieses Isolat frische Stämme zu verwenden.

Packungsgröße	Artikelnummern	Gewicht
5000 mL 250 Tests zu je 20 mL	VB912	Gewicht: 373,5 g
25 L 1250 Tests zu je 20 mL	VB913-25	Gewicht: 1867,5 g

WARNHINWEISE

- Platten nicht verwenden, wenn diese Anzeichen von Kontamination oder Beschädigung zeigen.
- Produkt nicht verwenden, wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten ist oder Anzeichen von Kontamination oder Beschädigung beobachtet werden.
- Nur für Laboranwendungen. Dieses Produkt darf nur von geschultem Laborpersonal und unter Einhaltung guter Laborpraktiken verwendet werden.
- Jede Abweichung von dem beschriebenen Verfahren kann die Ergebnisse beeinflussen.
- Jede Abweichung von der erforderlichen Lagertemperatur kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.
- Unsachgemäße Lagerung kann sich auf die Haltbarkeitsdauer auswirken.
- Die Flaschen/Ampullen müssen nach jeder Präparation wieder fest verschlossen und an einem trockenen, lichtgeschützten Ort aufbewahrt werden.
- Um einen guten Nachweis von Mikroorganismen zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Probenahme und -transport sorgfältig und entsprechend der jeweiligen Probenart unter Einhaltung guter Laborpraktiken durchgeführt werden.

ABFALLENTSORGUNG

Alle Platten und sonstigen kontaminierten Materialien müssen nach dem Gebrauch sterilisiert oder durch geeignete interne Verfahren und in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Die Platten können durch mindestens 20-minütiges Autoklavieren bei 121 °C unschädlich gemacht werden.

LITERATUR

Wissenschaftliche Artikel über dieses spezielle Produkt finden Sie im Bereich „Publications“ auf unserer Website.

Web link: <http://www.chromagar.com/publication.php>

ZEICHENERKLÄRUNG GEBRAUCHSANWEISUNG/ ETIKETT

- REF** Bestellnummer
- Gebrauchsanweisung beachten
- Die Basismenge reicht für X Liter Medium
- Haltbar bis
- Erforderliche Lagertemperatur
- Vor Feuchtigkeit schützen
- Vor Licht schützen
- Hersteller

Technische Dokumente:

Als Download erhältlich auf:
www.CHROMagar.com

- Analysenzertifikat (CoA) --> Eins pro Charge
- Sicherheitsdatenblatt (SDB)

Die Marken CHROMagar™ und Rambach™ wurden von Dr. A. Rambach entwickelt. ATCC® ist eine eingetragene Marke der American Type Culture Collection

NT-EXT-017 V8.0 / DE 05-May-21

培地の目的

本品は、V. parahaemolyticus、V. vulnificus およびV. choleraeを分離し検出するための発色酵素基質培地です。Vibrio genusは洋植物と動物に自然に見られ、その20属のうち4属 (V. parahaemolyticus、V. vulnificus、V. alginolyticus、V. cholerae) は食物媒介病原体。

組成

本品は、1種の粉末Baseから成ります。

本品	=	パック
合計 g/L		74.7 g/L
組成 g/L		寒天 15.0 ペプトンと酵母エキス 8.0 塩 51.4 発光物質混合物 0.3
形態		粉末
保存法		15~30 °C
培地の最終pH		9.0 +/- 0.2

調整方法 (1Lあたりの計量)

ステップ 1 混合物の調整

- 粉末Base74.7 g を1Lの精製水によく分散させる。
- 寒天が十分膨潤するまで攪拌する。
- 定期的に攪拌しながら加熱し、(100 °Cに)沸騰させる。
- 100 °C以上に加熱しないこと。オートクレーブで、121 °Cで加熱しないこと。
- 注意 1:オートクレーブを使用する場合は、圧力をかけずに使用すること。
- アドバイス 1:混合物を100 °Cに加熱する際、電子レンジを使用することもできます。最初に沸騰したら電子レンジから取り出し、静かに攪拌します。再度電子レンジに戻し、短時間の沸騰を繰り返して起こさせ、寒天の粒子を完全に融解させます (小さな泡から大きな泡に変わります)。

ステップ 2 分注

- 静かに攪拌しながら水浴にて45~50 °Cに冷却する。
- アドバイス 2:Aeromonasを多く含む検体の場合は、45-50 °Cに冷却した混合物にcefsulodin 50mgを加えることもできます (50 mg/L)。
- 滅菌ペトリ皿に培地を分注する。
- 乾燥させゲル化する。

保存法

- 使用前は暗所で保存すること。
- 調整した培地は室温でも1日は保存できます。
- 遮光して乾燥を避け、冷蔵 (2~8 °C) すれば、正しく調整された培地は1か月まで保存できます。

接種法

適切な先行エンリッチメントステップおよび、培地への直接塗抹により検体を培養します。

- 寒天培地が冷蔵保存されていた場合は、接種前に室温に戻す。
- 検体を培地に画線塗抹する。
- 好気条件下で、37 °Cで24時間培養する。

典型的な検体

例: 環境資料、水検体、海産物、資料表面


直接塗抹あるいは塗布法

CHROMagar™ Vibrio

結果の判定

微生物の種類	典型的なコロニーの形状
V. parahaemolyticus	→ 藤色
V. vulnificus / V.cholerae	→ 青緑色からターコイズブルー
V. alginolyticus	→ クリーム色

典型的なコロニーの形状

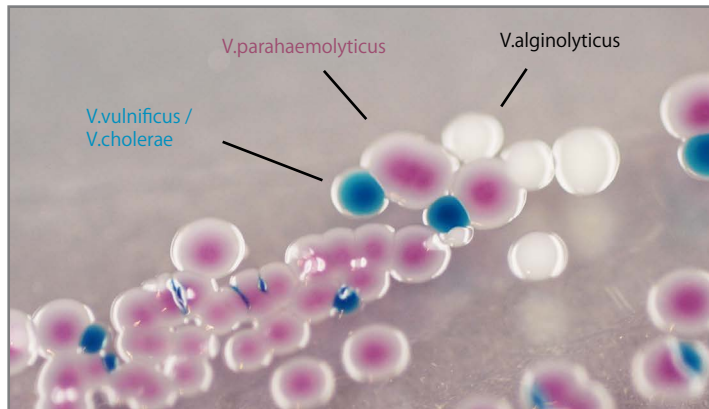

写真はあくまでイメージです。

性能と限界

- 最終同定には、補助的試験を行うこと。
- 青色コロニーのオキシダーゼ試験には、通常のオキシダーゼ試験を行うことを推奨します。
- 藤色コロニーのオキシダーゼ試験には、オキシダーゼ陽性細菌で青色になる試薬を使用することを推奨します(10 mg/mLの tetramethyl-p-phenylenediamine溶液)。

品質管理

培地の使用方法と地域の品質管理条例および規範に従って、品質管理を行ってください。
 適当な培地の調整は、以下のATCC菌株を分離することで検査できます：

微生物の種類	典型的なコロニーの形状
V. vulnificus ATCC® 27562*	→ 緑色
V. parahaemolyticus ATCC® 33845	→ 藤色
V. alginolyticus ATCC® 33839	→ クリーム色
S. aureus ATCC® 25923	→ 形成が抑制された
E. coli ATCC® 25922	→ 形成が抑制された

*この分離には、フレッシュな菌株を使用することを強く推奨します。

注意

- 培地にコンタミネーションや品質低下が認められる場合は、使用しないでください。
- 本品の有効期限が切れている場合や、本品にコンタミネーションや品質低下が認められる場合は使用しないでください。
- 実験室で使用すること。本品は研究用製品であり、優良実験室規範に則った専門家のみによって取り扱い可能です。
- 異なった使用方法で本品が使用された場合、結果に影響を及ぼす可能性があります。
- 定められた保存温度と異なる温度で保存された場合、本品の性能に影響を及ぼす可能性があります。
- 保存方法が不適切な場合、本品の有効期限に影響を及ぼす可能性があります。
- 調整に使用したボトル及び瓶のふたは使用後しっかりと閉め、湿気と光を避けて低湿度環境下で保管してください。
- 微生物検出の良い結果を得るために：優良実験室規範に従って検体を適切に収集、輸送すること。

廃棄物処分

試験終了後、使用した培地とコンタミネーションが認められた器具はすべて滅菌するか、適切な内部手続き及び地域の条例に従って処分すること。培地は、オートクレーブを121 °Cで最低20分間かけることで滅菌できます。

参照

本品に関する科学的発行物については、弊社ウェブサイトの「Publications」を参照してください。
 ウェブリンク: <http://www.chromagar.com/publication.php>

取扱説明書/ラベル・インデックス

- Xリットルの培地に対して必要な粉末量
- 有効期限
- 指定された保存温度
- 湿気を避けて保存すること

テクニカルドキュメントが必要ですか？

下記のウェブサイトからダウンロード可能です
www.CHROMagar.com

- Certificate of Analysis (CoA) --> One per Lot
- Material Safety Data Sheet (MSDS)

パックサイズ

5000 mL

試験250回分 / 1試験20 mL

=

注文番号

VB912

重量:373.5 g

25 L

試験1250回分 / 1試験20 mL

=

VB913-25

重量:1867.5 g

CHROMagar™ およびRambach™ は、Dr A. Rambachの商標です。
 ATCC®は、American Type Culture Collectionの登録商標です。
 NT-EXT-017 V8.0 / JP 05-May-21